

Figura 4.2 Estas imágenes representan una mujer de 24 años que tenía imágenes preoperatorias de mamas, simulación preoperatoria e imágenes posoperatorias usando el implante de silicona Allergan Inspira Smooth Round Moderate de 275 mL. (a-c) Vista frontal. (d-f) Vista aérea. (g-i) Vista de ojo de gusano. (j-l) Vista oblicua derecha.

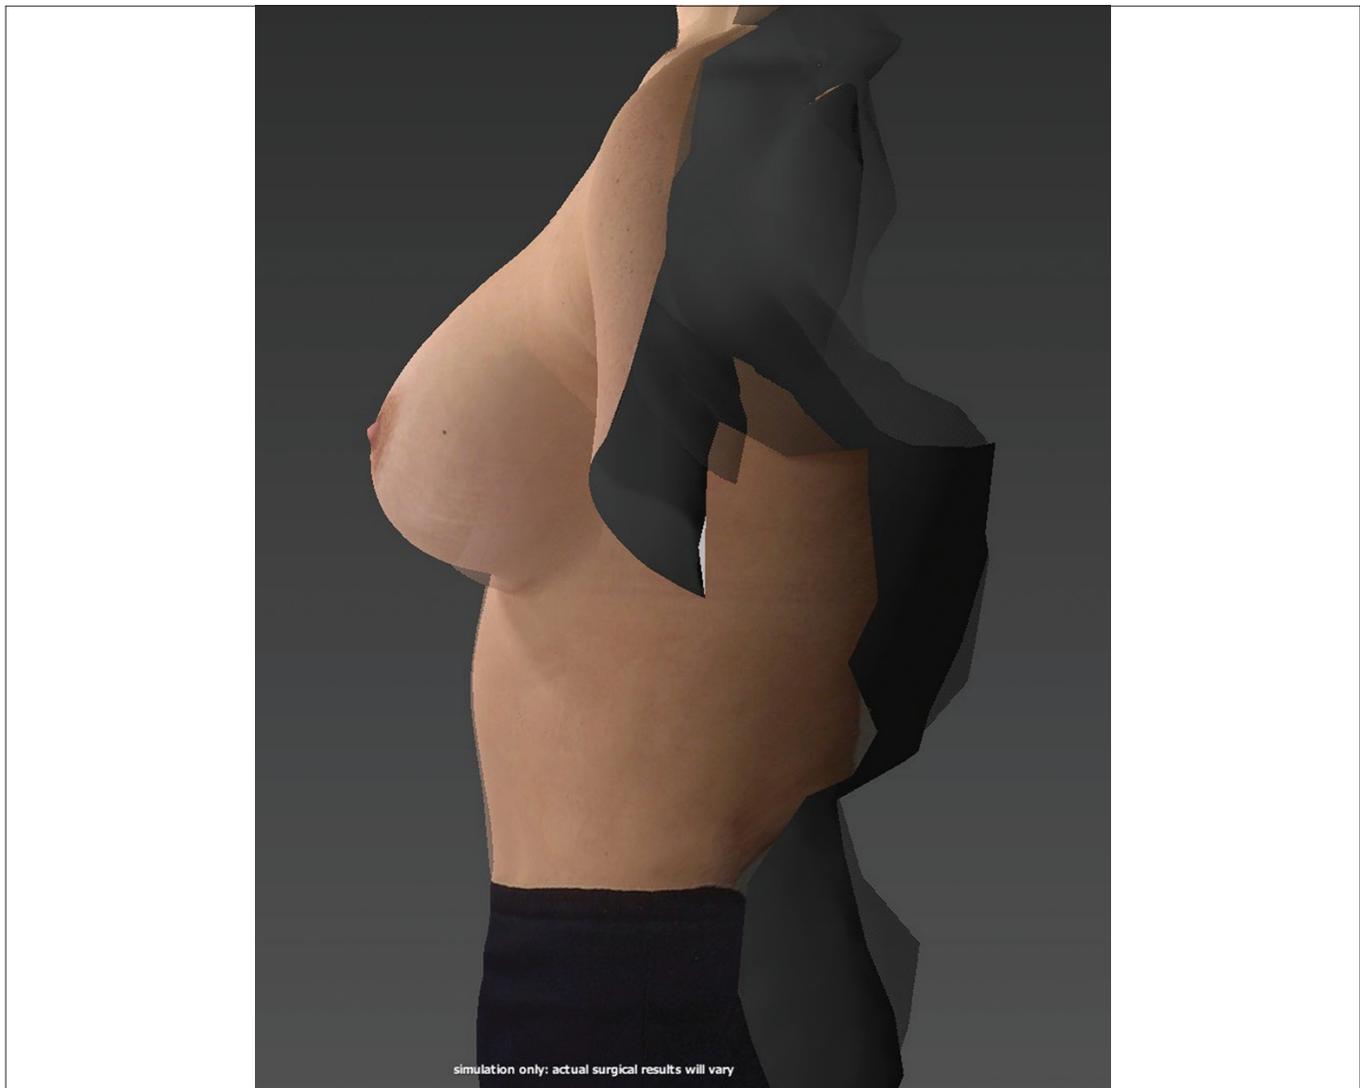


Figura 4.3 Esta imagen presenta una superposición de la simulación preoperatoria y la imagen posoperatoria de la figura 4.2, destacando la simetría de ambas imágenes.